






G-Oral Scan2 Cart

G-Oral Scan2 / Aoralscan3

① 製品

① 梱包内容

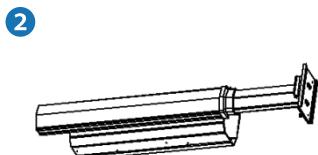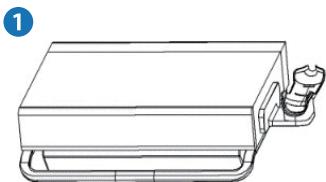

- ① パソコン台 (スキャンブラケット付)
- ② サポーター (支柱)
- ③ 四輪ベース
- ④ 六角レンチ
- ⑤ ノートパソコン用滑り止めパッド


② 製品仕様

寸法 (W×D) : 上部 460×370mm (パソコンは380×280mm 未満のものを使用してください)

下部 460×480mm

高さ : 850 - 1280mm

収納スペース

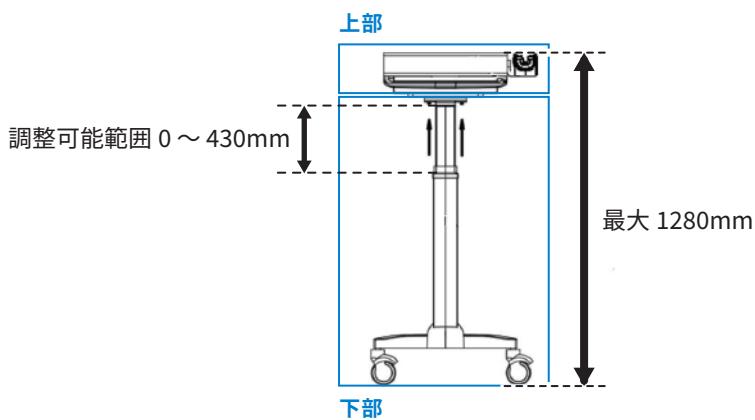

重量 : 18kg (上部 8kg / 下部 10kg)

耐荷重 : 20kg

③ 使用上の注意

本製品は、G-oral scan2 / Aoralscan3 のノートパソコン専用カート

移動時の落下や破損を防ぐ為、カート上の物は適切に配置し、カートに寄りかからない

転倒を防ぐ為、カートの上に余分なものを置いたり、ぶら下げたりしない


また、カートを移動させる場合はやさしく押して動かす

移動時はホイールのロックを解除して移動し、所定の位置でホイールを固定する


使用時は、ホイールがロックされていることを確認してから使用する

②組立方法


① サポーター下部のネジ 4 本を取り外す

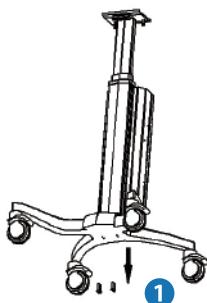

② 4輪ベースにサポーターを差し込む

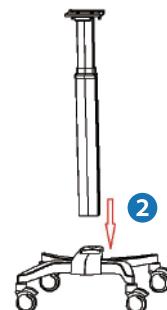




③ 4輪ベース下部のネジを締める



④ リリースボタンを押しながら、レールに沿ってパソコン台をスライドさせる



リリースボタン

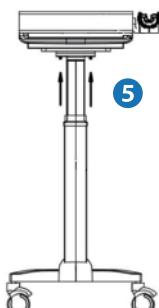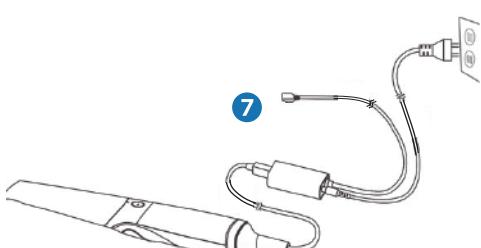⑤ パソコン台下部のネジ 2 本で
パソコン台を固定する⑥ サポーターの高さを調整する黒いノブを外側に開き、
サポーターの高さを反時計回りまたは時計回りに調整する⑦ スキャナプラケットにスキャナをセットし、
電源を入れ、USB ケーブルを PC に接続する

⑧ パソコン台に滑り止めパッドを置きその上に PC を置く

